


RI棟 2階 機器配置図



DNAシーケンサー SeqStudio①・②

リアルタイムPCR

QuantStudio 6 Pro

QuantStudio3

PyroMark Q24

バイオアナライザー

デジタルPCRシステム

T100 Thermal Cycler


マルチラベルプレートリーダー EnVision

マイクロプレートフォトメーター

Multiskan FC

ケミルミ撮影装置
FUSION FX

セミナー室

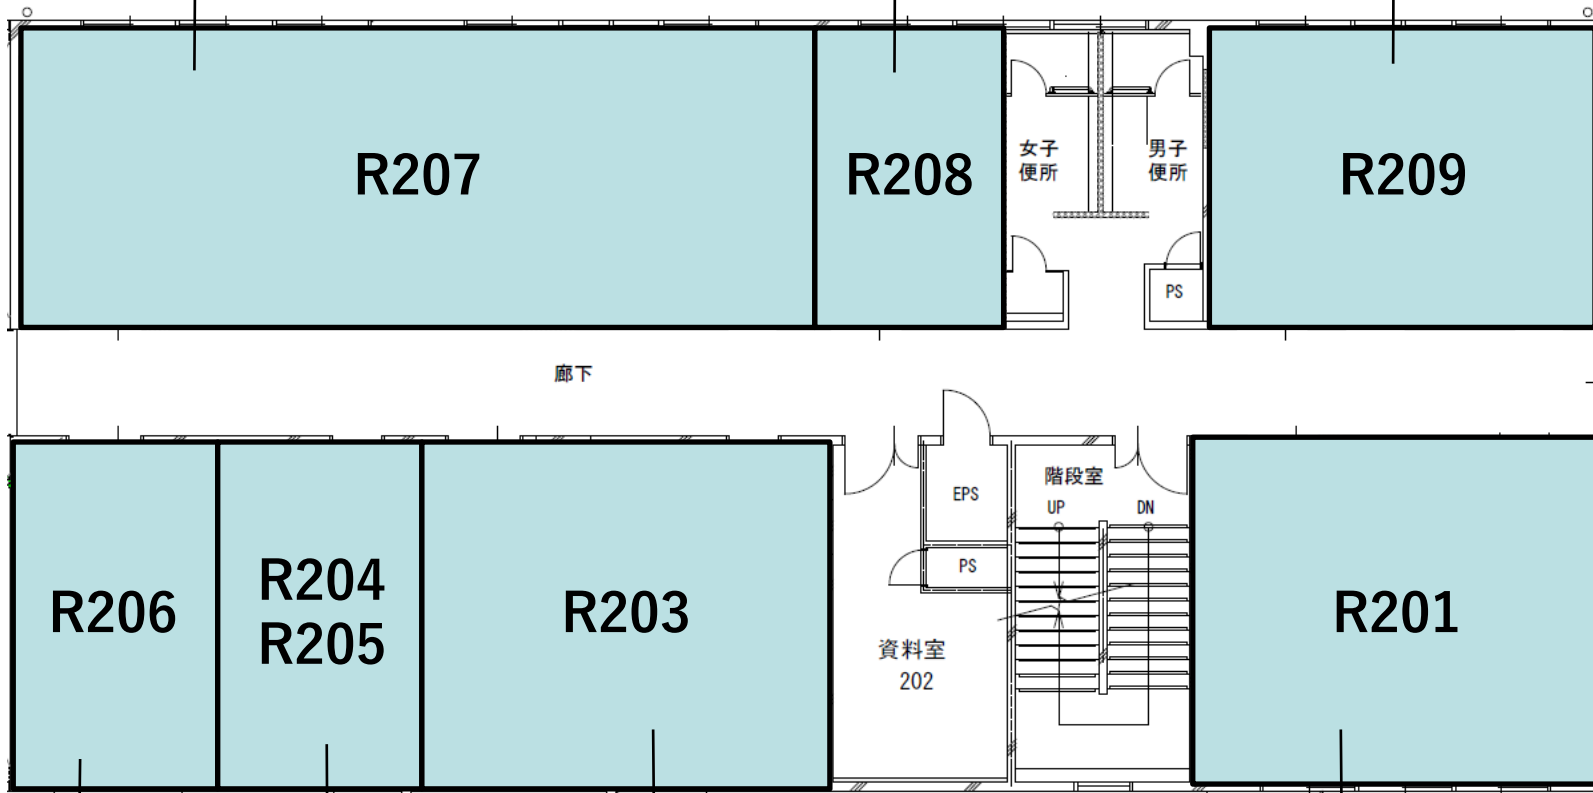

イオンコーター IB-3

真空恒温器 DP-41

パラフィン溶融器

凍結乾燥機 ID-2

ドラフト

液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8030

液体クロマトグラフ Prominence

ガスクロマトグラフ 2014

ドラフト

キャピラリーウェスタンシステム Abby

多本架冷却遠心機 AX-511

クライオスタット NX50



ウルトラマイクローム ULTRACUT N

マイクローム


ガラスナイフメーカー EM-25A

正立顕微鏡 Nikon SE


1 階 機器配置図

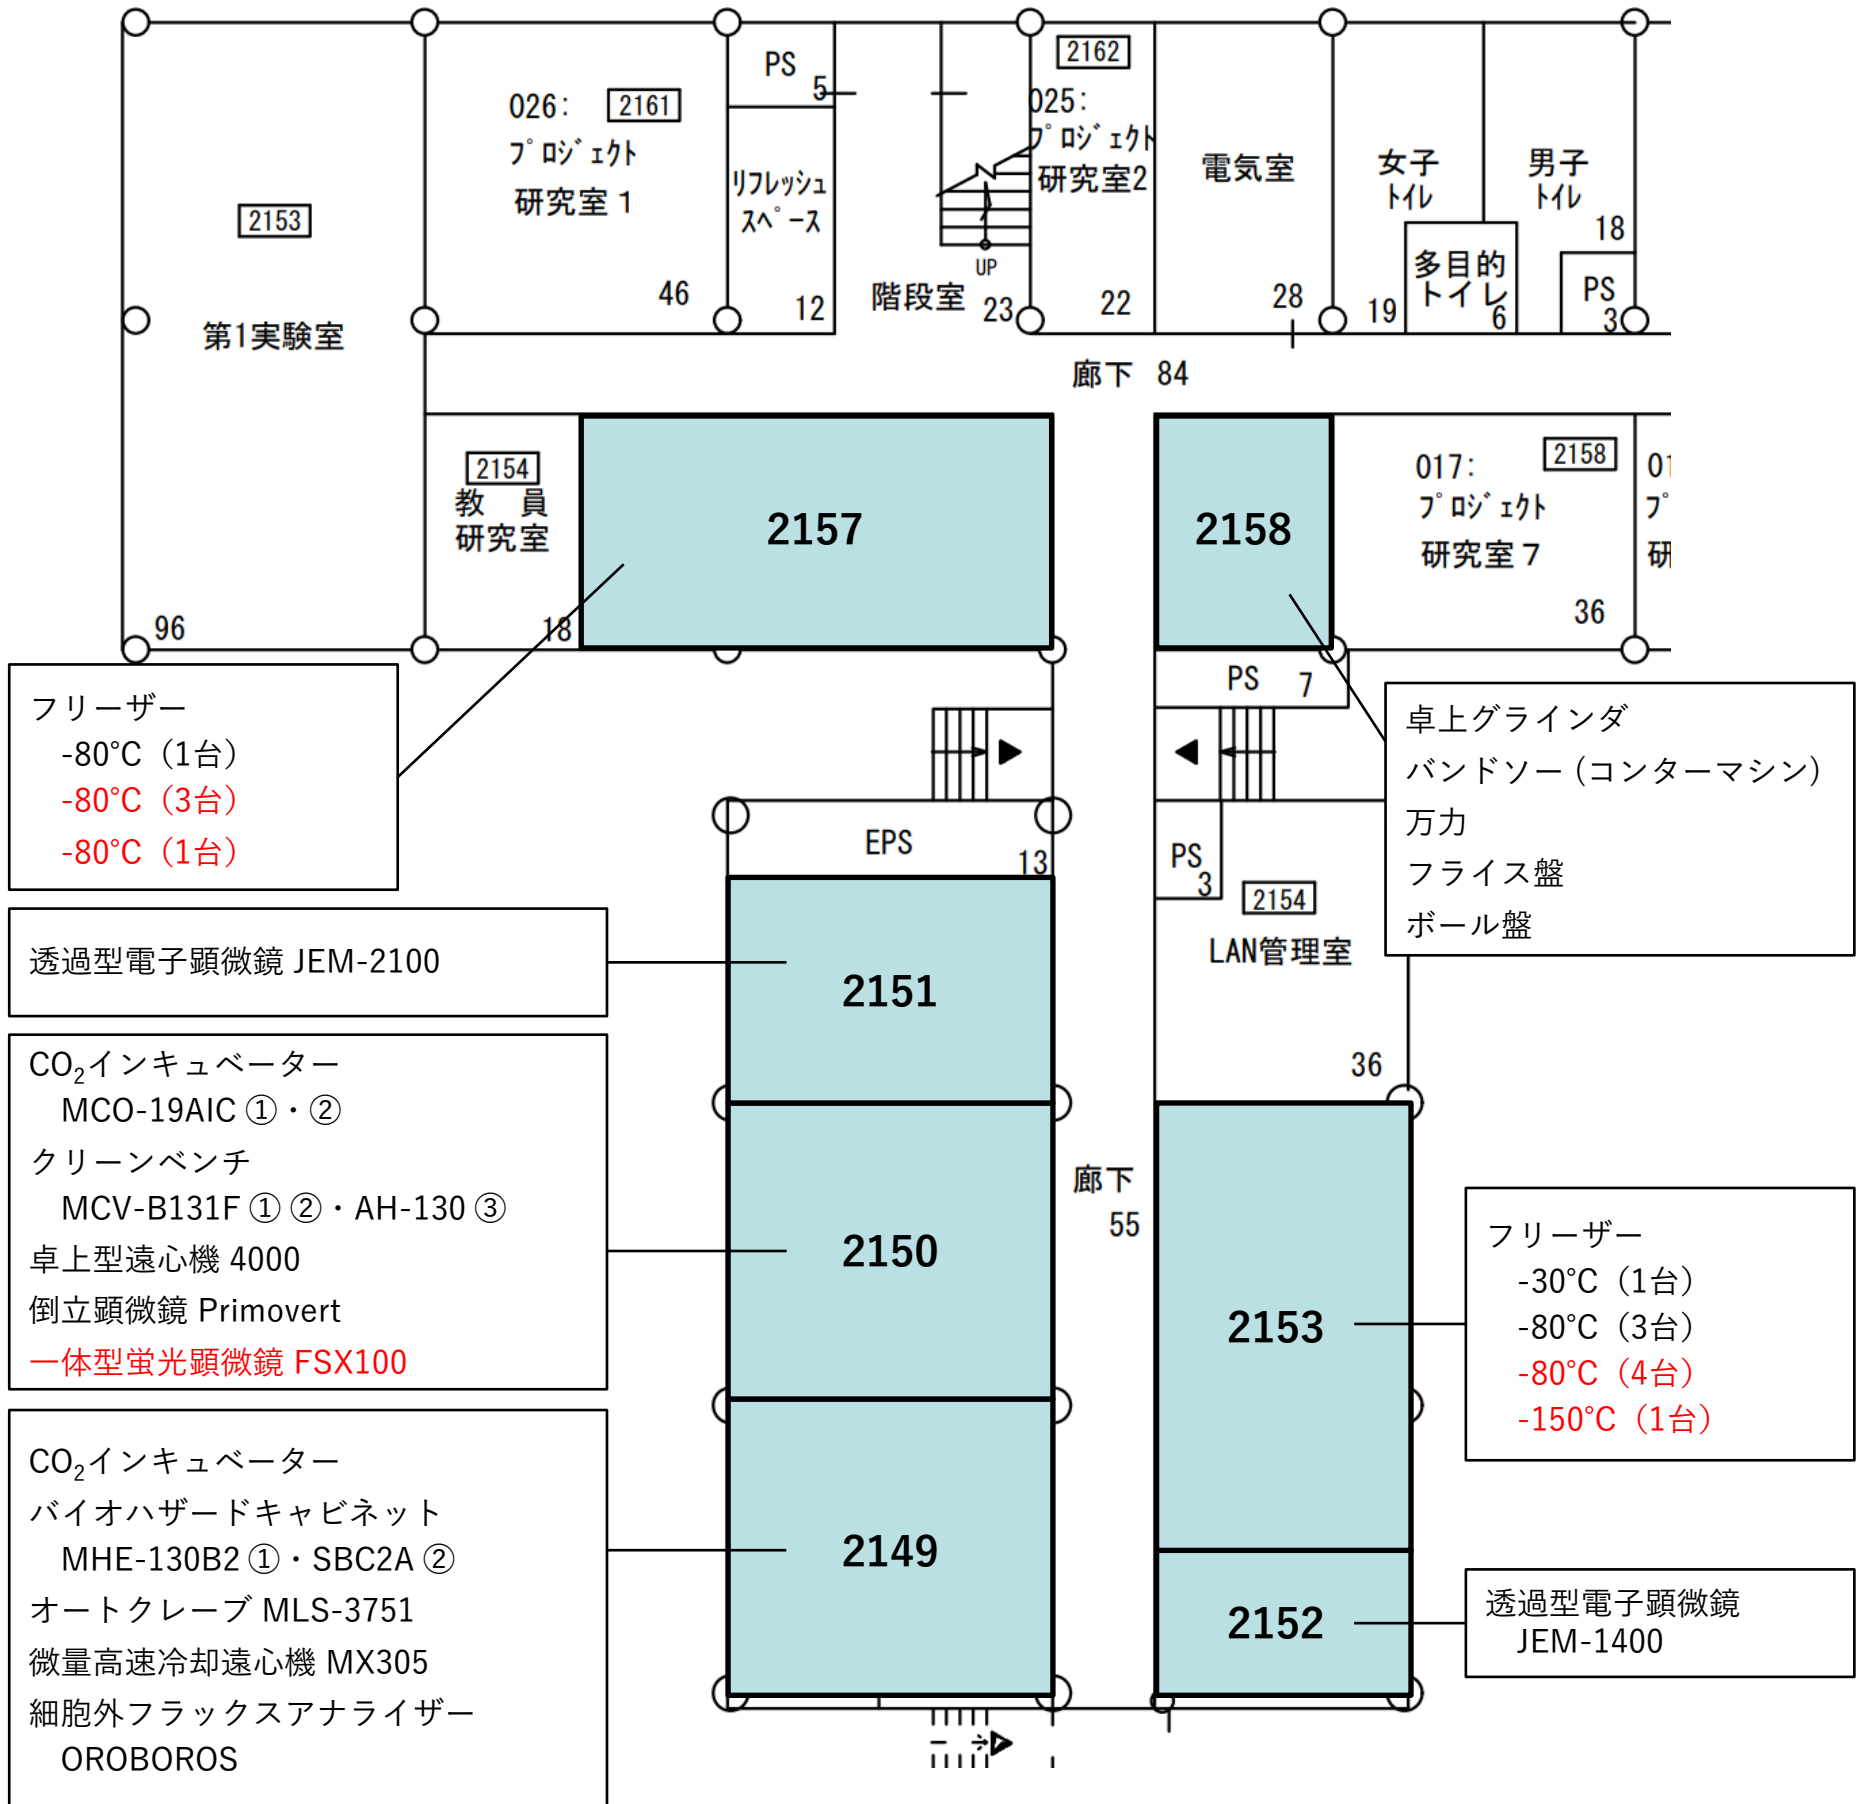

2階 機器配置図



臨床研究棟

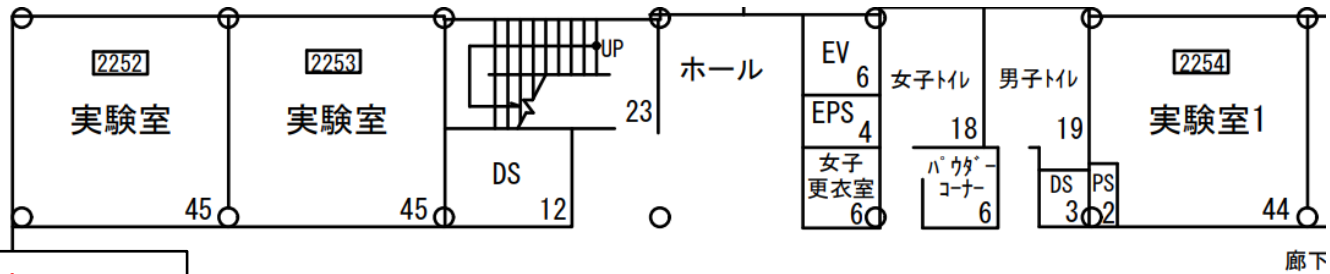



遺伝子導入装置 NEPA21
 超音波洗浄機 3200-J4
 電子天秤 R200D・TXB6201L
 pHメーター F-55S
 ドラフト

クリーンベンチ MCV-B91F
 恒温器 IC101
 振とう培養器 BR-43FL
 電子天秤 TW323N・AG204
 ガラス器具等

センター管理室
 フローサイトメトリー解析ソフト
 FlowJo ① ②
 デジタルPCR解析ソフト
 LCMS解析ソフト
 OctoMACS

自動現像機 CEPROS-Q
 トランスイルミネーター
 PyroMark Q48 Autoprep


蒸留水製造装置 Glass Still 8型
 超純水製造装置 Milli-Q EQ7000
 乾熱滅菌器SG-62 ① ②
 オートクレーブLSX-500 ② ③
 超音波発生器 UD-200
 ポリトロンホモジナイザー

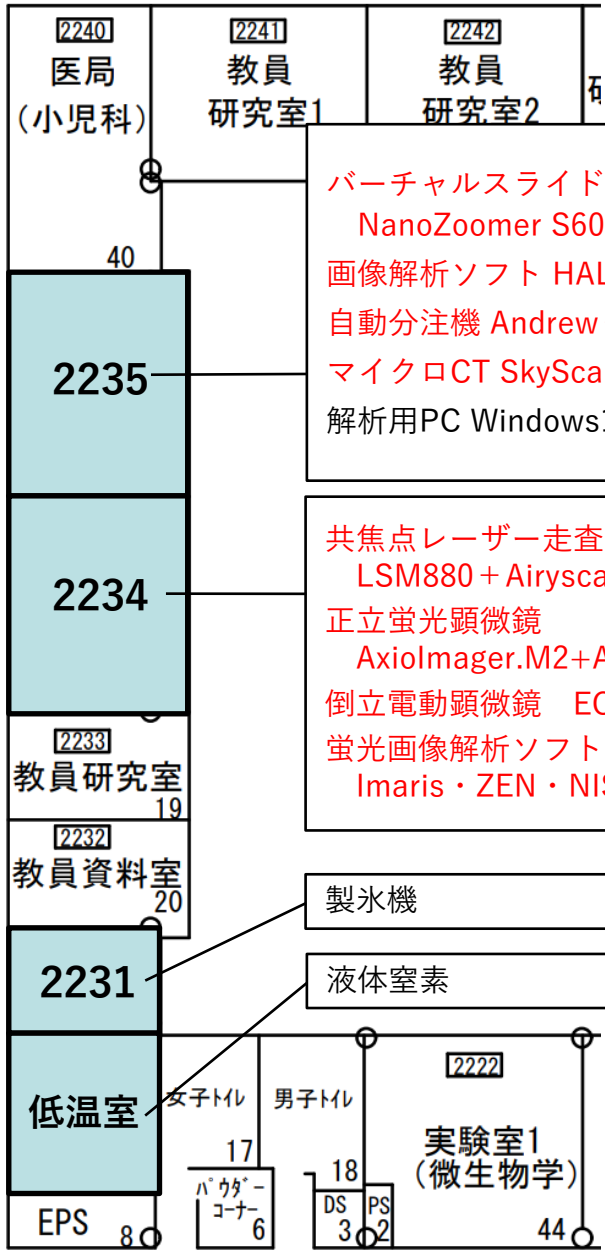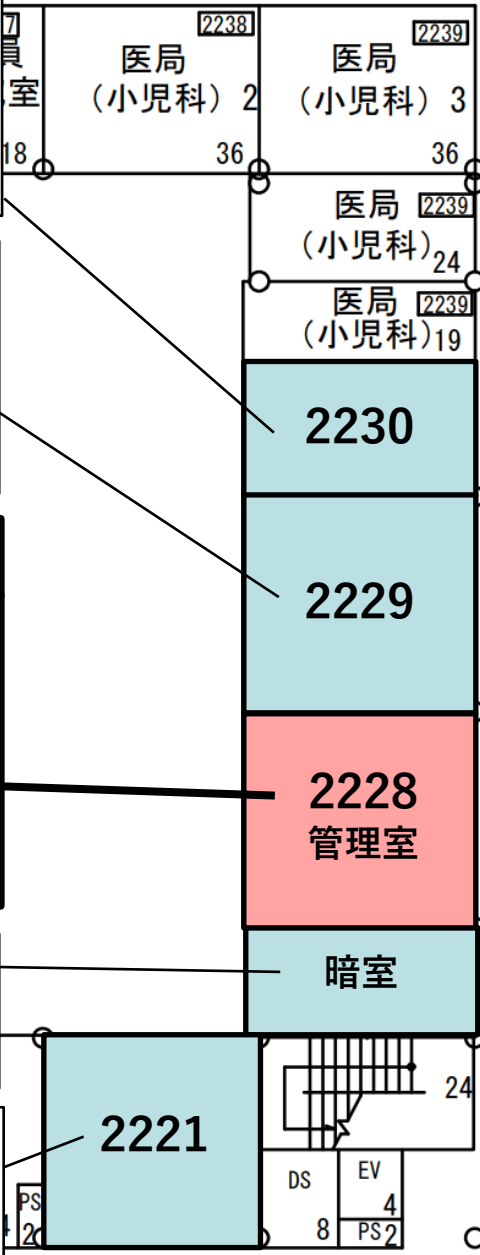

バーチャルスライドスキャナ
 NanoZoomer S60
 画像解析ソフト HALO・HALO AI
 自動分注機 Andrew+
 マイクロCT SkyScan (解析)
 解析用PC Windows10Pro


共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡
 LSM880 + Airyscan Fast
 正立蛍光顕微鏡
 Axiolmager.M2+ApoTome.2
 倒立電動顕微鏡 ECLIPSE Ti2
 蛍光画像解析ソフト
 Imaris・ZEN・NIS.ai

製氷機
 液体窒素

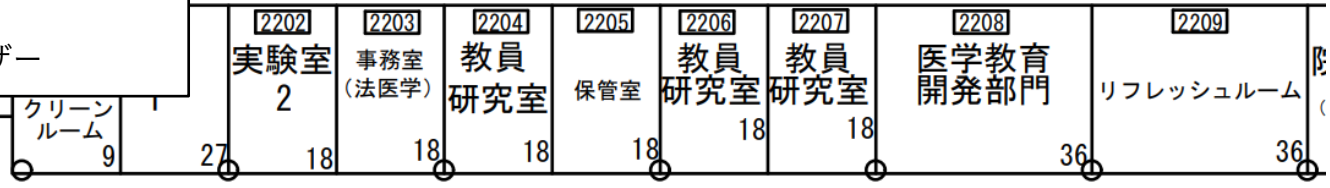

基礎研究棟

3階 機器配置図

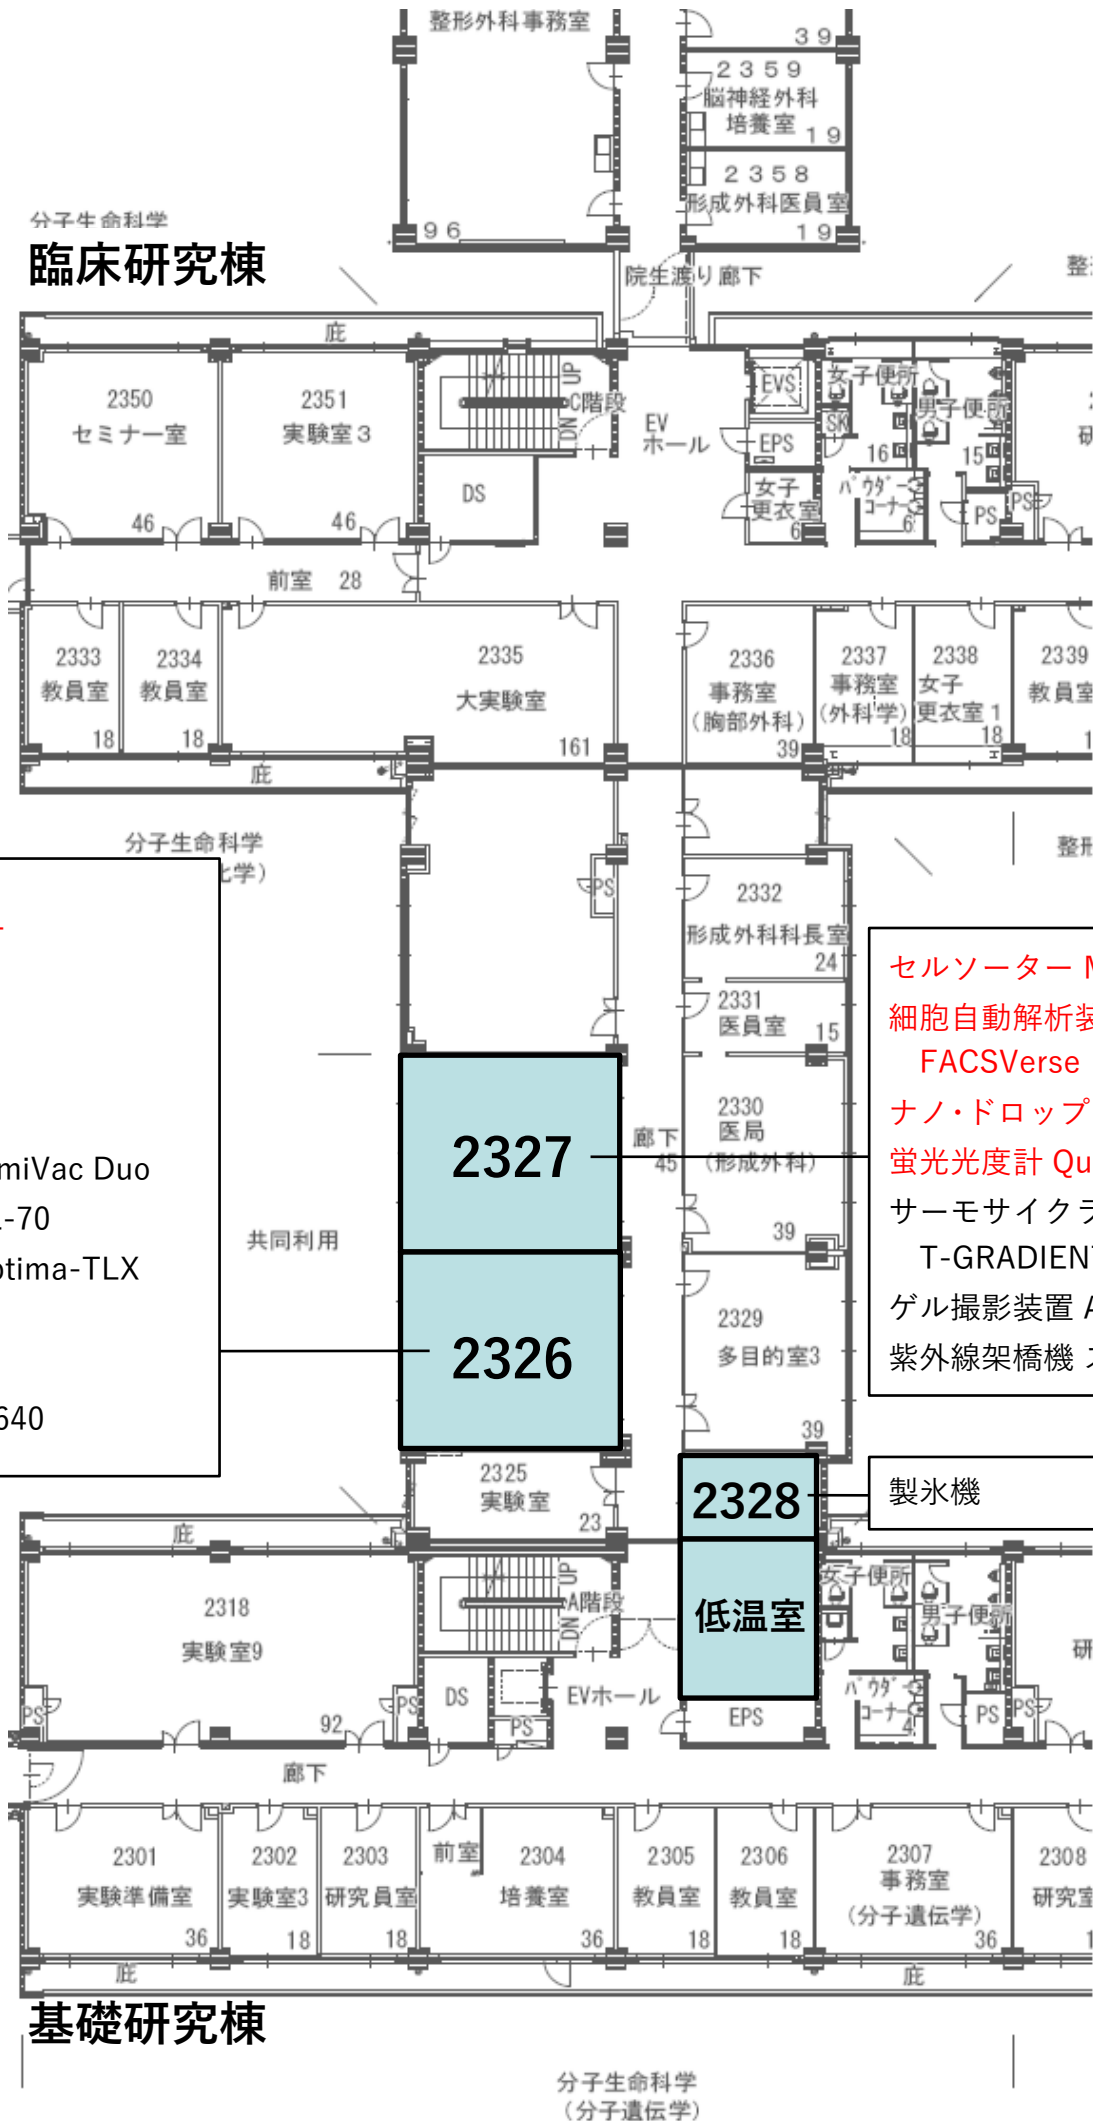


- 多本架冷却遠心機 LX-141
- 多検体細胞破碎装置
- シェイクマスターネオ
- 振とう培養器 E25R
- 恒温振とう機 G-25
- 卓上遠心エバポレーター miVac Duo
- 分離用超遠心機 Optima L-70
- 卓上型分離用超遠心機 Optima-TLX
- 高速冷却遠心機 HP-25
- 凍結乾燥機 FDU-2100
- 紫外可視分光光度計 DU-640

- セルソーター MA900
- 細胞自動解析装置
- FACSVerse・MACSQuant
- ナノ・ドロップ 2000c
- 蛍光光度計 Qubit 4
- サーモサイクラー
- T-GRADIENT・GeneAmp 2720
- ゲル撮影装置 AE-6933FXCF
- 紫外線架橋機 ストラターリンカー


製氷機

動物棟 機器配置図




2階

IVIS LuminaIII
※感染実験中のため、通常利用停止中

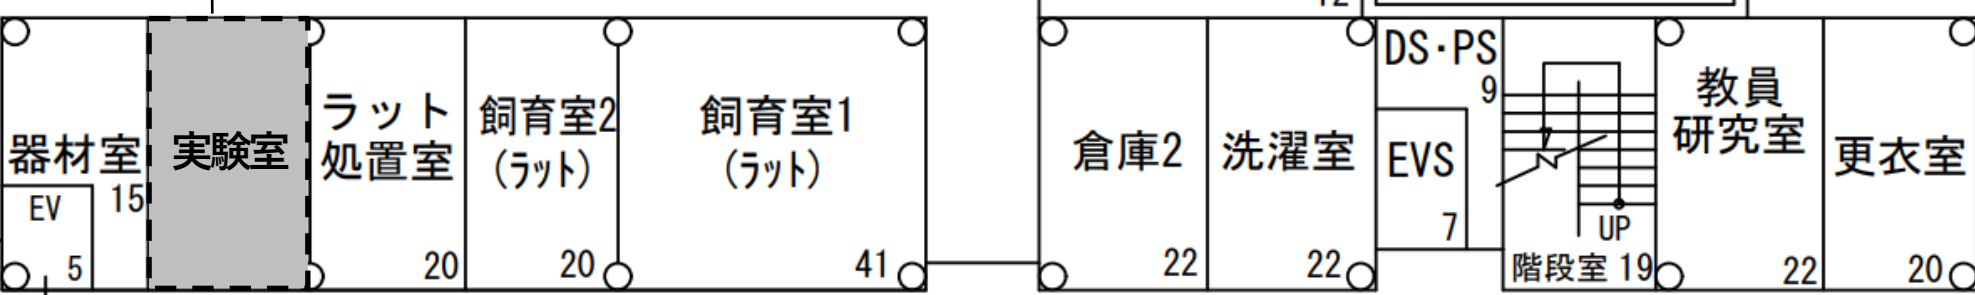


廊下 47

廊下 52

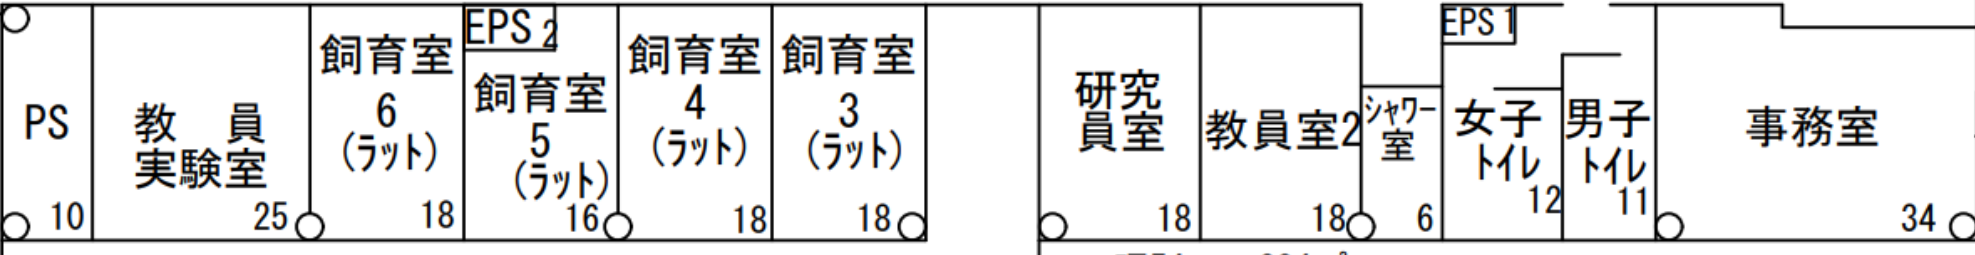


3階

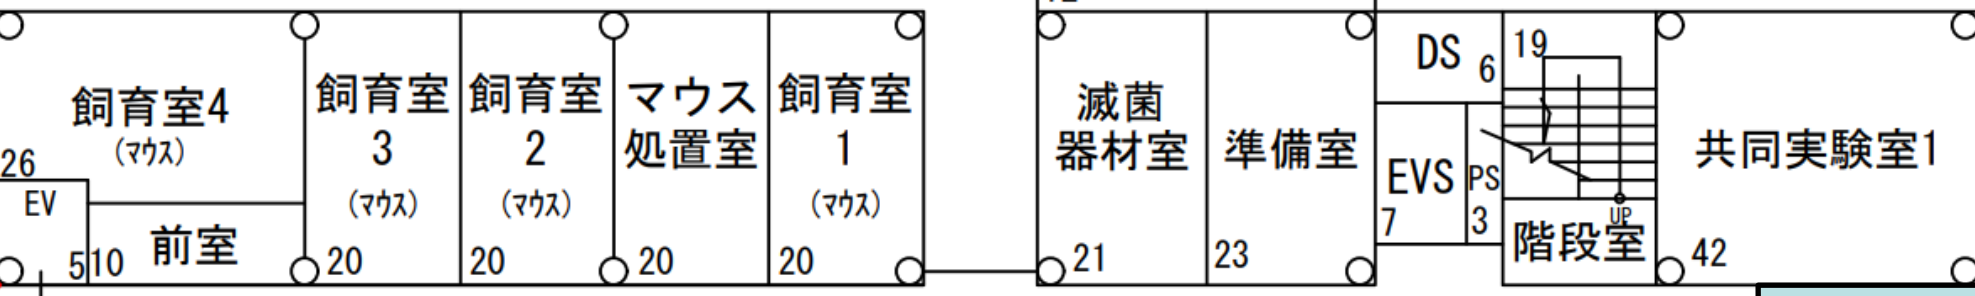

廊下 48

廊下 41

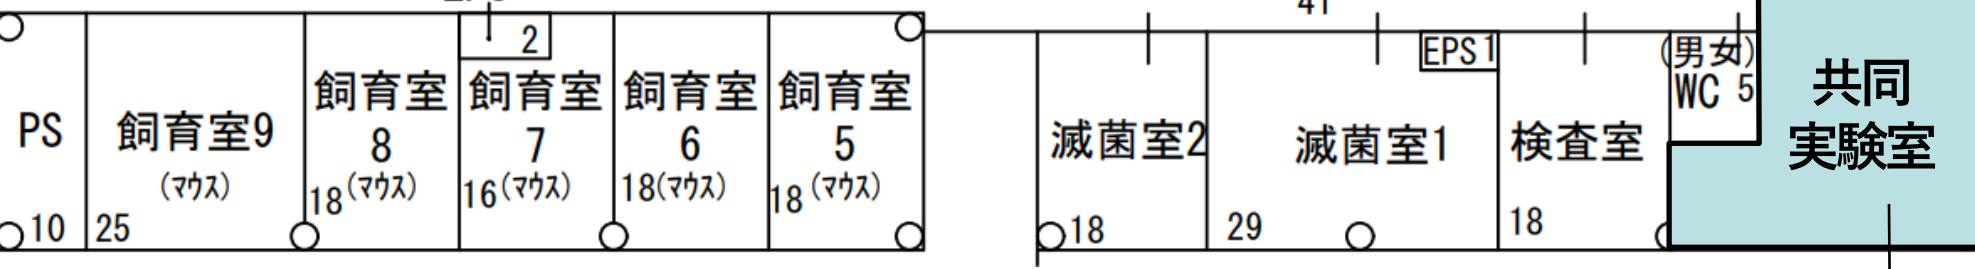

マイクロCT SkyScan 1276